


# 術中ICG蛍光血管造影法



手術中に脳血管内の温存を確認します。



処置前

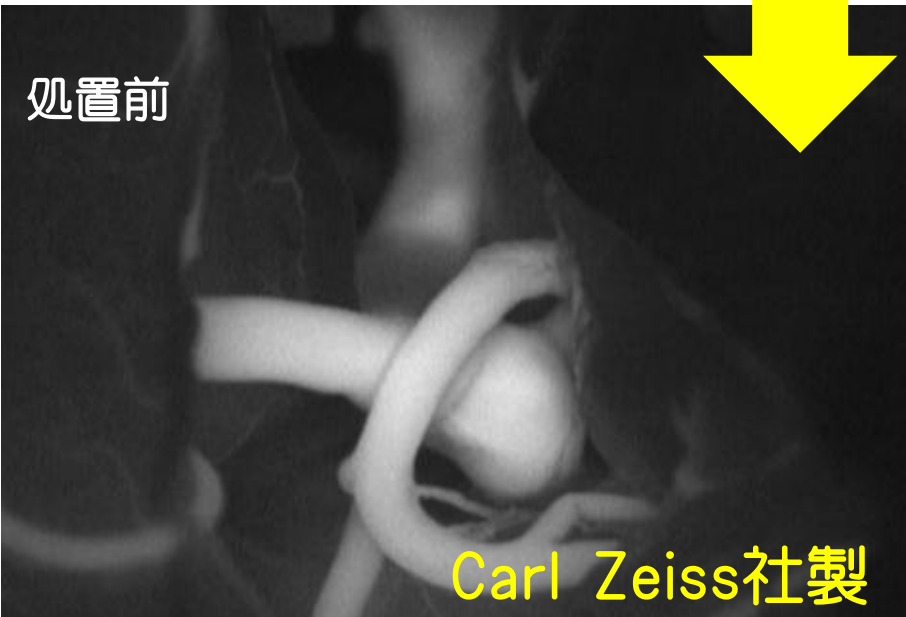

Carl Zeiss社製

処置後



OPMI Pentero800使用